SCALP GROW UP SYSTEM 「スカルプグローアップシステム」取扱説明書

製品No.

品質保証書

このたびは、スカルプグローアップシステムをお買い求めいただきありがとうございます。本器は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。

※本器の保証は、日本国内で使用の場合に限ります。This warranty is valid only in Japan.

品　名　スカルプグローアップシステム　　型　番　S5-7300

お名前

ご住所

ＴＥＬ

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。

お買い上げ店名　　㊞

住　所

ＴＥＬ　　お買い上げ年月日

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 本体が保証対象となります。
3. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店に依頼してください。なお、輸送の際は販売店までの送料の負担をお願いします。
4. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷。ニ）本書の提示が無い場合。ホ）本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。ヘ）消耗部品。ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
6. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。
7. 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用致しません。

株式会社 グラント・イーワンズ　メンテナンスセンター
本器を修理にお出しになる場合は、下記までお送りください。
〒910-0064
福井県福井市新田塚町305番地
TEL. 0776-26-2800

【お問合せ先（株式会社 グラント・イーワンズ）】
0120-34-4677

製造販売元
株式会社ジャパンギャルズ
香川県高松市南新町8番14号 JG-B.L.D

1 安全上のご注意

●この製品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用前は必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください●お読みになった後はいつも手元においてご使用ください●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい●表示と意味は次のようになっています

⚠危険	守らないと生命や身体に重大な被害を負う危険の発生が想定される内容
⚠警告	守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容
⚠注意	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容

図記号の例

⃠記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は ⃠ の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。

この記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、近くに文章や絵で示します。左図の場合は“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

⚠危険

●誤動作を招く恐れがありますので、下記のような医療用電子機器との併用は絶対にしないでください（1）ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器（2）人工心肺などの生命維持用電子医療機器（3）心電計などの装着型の医療用電子機器●強い電気ショックを受けたり、やけどや感電の恐れがありますので入浴中や、浴室などの湿度の高い所でのご使用はおやめください

⚠警告

次のような人・部位には、事故やトラブルの原因になりますので絶対にご使用しないでください
●心臓に疾患がある人●医師の治療を受けている人●急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の人●てんかん症の人●ケロイド体質の人●金属アレルギーの人●その他体調のすぐれない人（37度以上の熱があるとき・血圧に異常がある時・頭痛のあるとき）●頭皮に異常がある人（アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質で特にお肌が敏感な人・化粧品などによる皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで赤ヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビが化膿し（黄ニキビ）、炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な（内臓疾患などによる）シミのある人）●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人●血友病患者●飲酒中や薬を服用中の人●疲労の激しい人●痛覚・知覚に障害のある人

<部位>●剃毛・パーマ・毛染めした直後の部位●心臓の上●陰部●眼球部分●上まぶた●耳●喉ぼとけの周辺●口の中等粘膜の部位●皮膚疾患のある部位●傷口●悪性腫瘍●顔面黒皮症●体内に金属やプラスチック・シリコン等を埋め込んでいる部位●整形をされた直後の部位●指定部位以外
※通院中の方・生理中の方・妊娠中の方は医師にご相談の上、ご使用ください
※乳幼児へのご使用は避けてください

●強いショックを受ける恐れがありますので必ず身に付けている全ての貴金属類（ベルト・ネックレス等）をはずしてからご使用ください●クシ部を頭皮へ強く押し付けたり、1ヶ所へ長時間固定したままにしないでください●本体の動作などに異常を感じた場合は、ただちに電源を切りご使用を中止して、取扱店に連絡してください

●指定のトリートメント以外の目的にはご使用しないでください●体調不良をおこすことがありますので指定のトリートメントが修了した直後に、再度同一部位をトリートメントしないでください（次のご使用までは少なくとも5時間以上休止してください）●感電事故の恐れがありますので、他の電気製品（美容器など）との同時使用はしないでください●火災・感電・故障の原因になりますので異物を本体内部に入れないでください

修理・改造は行わないでください。感電及び異常動作により、身体に重大な被害を与える恐れがあります

⚠注意

次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。
●身体に異常（気分が悪くなる、痛みを感じる）特に発赤、カブレなどの皮膚の異常を感じたら直ちにご使用を中止してください●ライトの光を長時間直視しないでください●3ヶ月以上ご使用しなかった場合、発売元で点検を受けてください（有償）本体内部に埃などが付着していた場合、発火などの恐れがあります●感電などの恐れがあるのでご自分での点検は絶対に行わないで下さい●本体の上に重い物を置いたり、衝撃（高い所からの落下など）を与えないでください●本体は濡らさないでください●お手入れをするときは、シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などはご使用しないでください●電池の取扱いについては、次の事項を必ずお守りください（電池のプラスとマイナスの向きを表示通りに正しくセットしてください・古い電池や種類の違う電池をご使用しないでください・長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外しておいてください・液もれが起こった場合は、本体についた液をよく拭き取り、新しい電池に交換してご使用ください・ご使用済みの電池は、お住まいの市町村の定める区分に従って破棄してください・電池を火中に投入しないでください）

2 ご使用上のご注意

本体のお手入れ

ご使用後、本体に付着した汚れは布などでよく拭き取り、清潔な状態で保管して下さい

本体を水洗いしないでください　本体は防水仕様ではありません　薬品類・洗剤はご使用しないでください

保管場所

本体のお手入れ後は以下の点にご注意の上、保管してください

乳幼児の手の届かない場所　直射日光のあたらない場所　温度・湿度の高くない場所

3 セット内容と各部の名称

●本体×1体●単3アルカリ乾電池×4本●取扱説明書（本書）×1冊

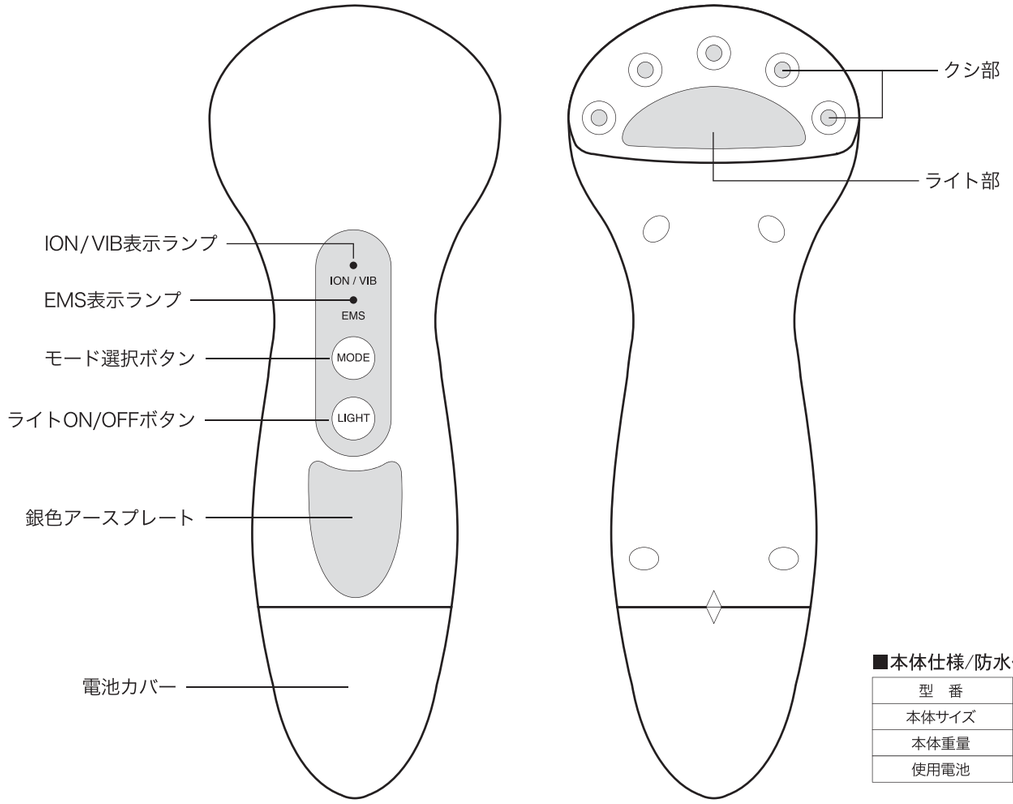

■本体仕様/防水仕様ではありません

型　番	S5-7300
本体サイズ	約 W75×D100×H200mm
本体重量	約142g
使用電池	単3アルカリ乾電池×4本

4 電池のセットのしかた

電池のセットのしかた

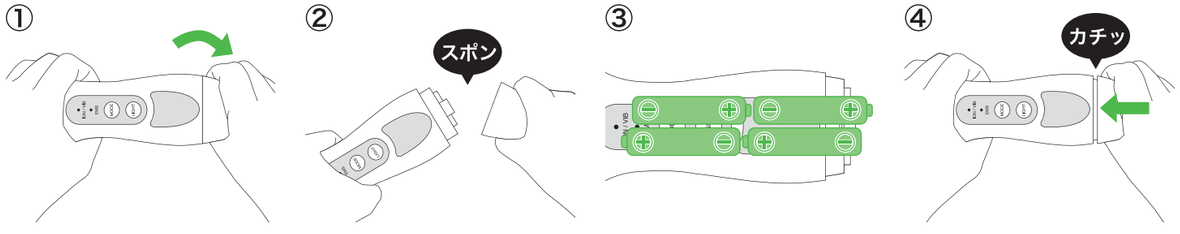

①本体を図のように持ち、電池カバーを矢印の方向に曲げて横側に開けてください。

②本体内側の電池入れ方向表示シールを参考に電池をセットしてください

③電池の向きを間違えないようにセットしてください

④電池カバーをきちんと閉めてください

＜電池の交換時期＞●出力が弱くなったり、ランプの色がうすくなった・点灯しなくなった場合は、新しい乾電池と交換してください
＜注意＞●電池をセットしたまま1ヶ月以上放置すると液漏れの恐れがありますので,長期間ご使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください
●電池メーカーの種類によっては、電池が取り出しにくくなる場合がありますので、本体を軽く振るなどして取り出してください

5 操作方法

機能選択

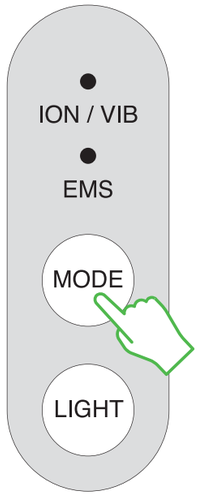

モード選択ボタンのながれ

イオン/バイブレーション
ION/VIB表示ランプ（赤）点灯
↓
EMS・弱
EMS表示ランプ（赤）点灯
↓
EMS・中
EMS表示ランプ（赤）点滅（遅）
↓
EMS・強
EMS表示ランプ（赤）点滅（速）
↓
電源OFF
EMS表示ランプ消灯

① モード選択ボタンを1回押す
イオン/バイブレーション機能がスタートします

② モード選択ボタンを2回押す
イオン/バイブレーション機能が終了し、EMS機能の出力〔弱〕がスタートします

③ モード選択ボタンを3回押す
EMS機能の出力が〔中〕に変更されます

④ モード選択ボタンを4回押す
EMS機能の出力が〔強〕に変更されます

⑤ モード選択ボタンを5回押す
EMSランプが消灯して、電源がOFFになります

ライトON・OFF

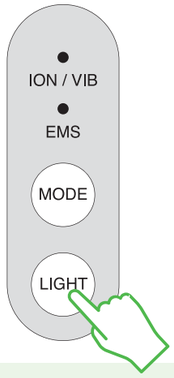

ライトON/OFFボタンのながれ

ライト
ライト部点灯
↓
ライトOFF
ライト部消灯

各トリートメントをモード選択ボタンで選択した状態でのみご使用できます（ライトのみではご使用できません）

① ライトON/OFFボタンを1回押す
ライトが点灯します

② ライトON/OFFボタンを2回押す
ライトがOFFになります

トリートメントのながれ

スカルプクレンジングオイル → 洗髪 → EMS（低周波）（全体で約5分程度） → イオン/バイブレーション（全体で約5分程度）

6 操作手順

EMS機能

① 洗髪後、軽くタオルドライをしてください

② EMS機能の出力を選択し、クシ部を頭皮に軽く押しあて、ゆっくり移動させるようにご使用ください

トリートメント中に頭皮が乾いてきたら再度、湿らせてください

◆ ライトが併用できます
ライトON/OFFボタンを押して、ライトをONにしてください

③ ご使用後、本体に付着した汚れは布などでよく拭き取ってください

最後にモード選択ボタンを押してから、5分経過しますと電源が自動的にOFFになります

⚠ ご注意



5本のクシ部は頭皮に同時にあててください



防水仕様ではありませんので水に浸けないでください

クシ部を頭皮に強く押しつけたりこすったりしないでください

イオン/バイブレーション機能

① 洗髪後、軽くタオルドライをしてください

② イオン/バイブレーション機能を選択し、本体の銀色アースプレートに手が触れるように持ち、クシ部を頭皮に軽く押しあててご使用ください

トリートメント中に頭皮が乾いてきたら再度、湿らせてください

◆ ライトが併用できます
ライトON/OFFボタンを押して、ライトをONにしてください

③ ご使用後、本体に付着した汚れは布などでよく拭き取ってください

最後にモード選択ボタンを押してから、5分経過しますと電源が自動的にOFFになります

⚠ ご注意



5本のクシ部は頭皮に同時にあててください



防水仕様ではありませんので水に浸けないでください

クシ部を頭皮に強く押しつけたりこすったりしないでください